


- 測定点(最終測定値)
- ▲ : 0.00 μ Sv/h 以上
 - : 0.10 μ Sv/h 以上
 - ◆ : 0.20 μ Sv/h 以上
 - ★ : 0.23 μ Sv/h 以上
 - ☆ : 0.40 μ Sv/h 以上
 - : 0.60 μ Sv/h 以上


- 最終測定年
- ⋯ : 2012
 - ⋯ : 2013
 - ⋯ : 2014
 - ⋯ : 2015
 - ⋯ : 2016
 - ⋯ : 2017
 - ⋯ : 2018
 - ⋯ : 2019

2011年 6月9日 訂正版 1年間の推定積算線量

単位はシーベルト、平成24年3月11日までのおよそ1年間の推定積算線量。(測定開始日は地域により異なる) 資料提供資料より複製。

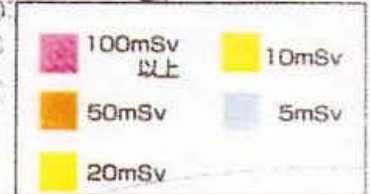

掲載データは測定初年度の値と最終測定年およびその前の測定年に絞りました。

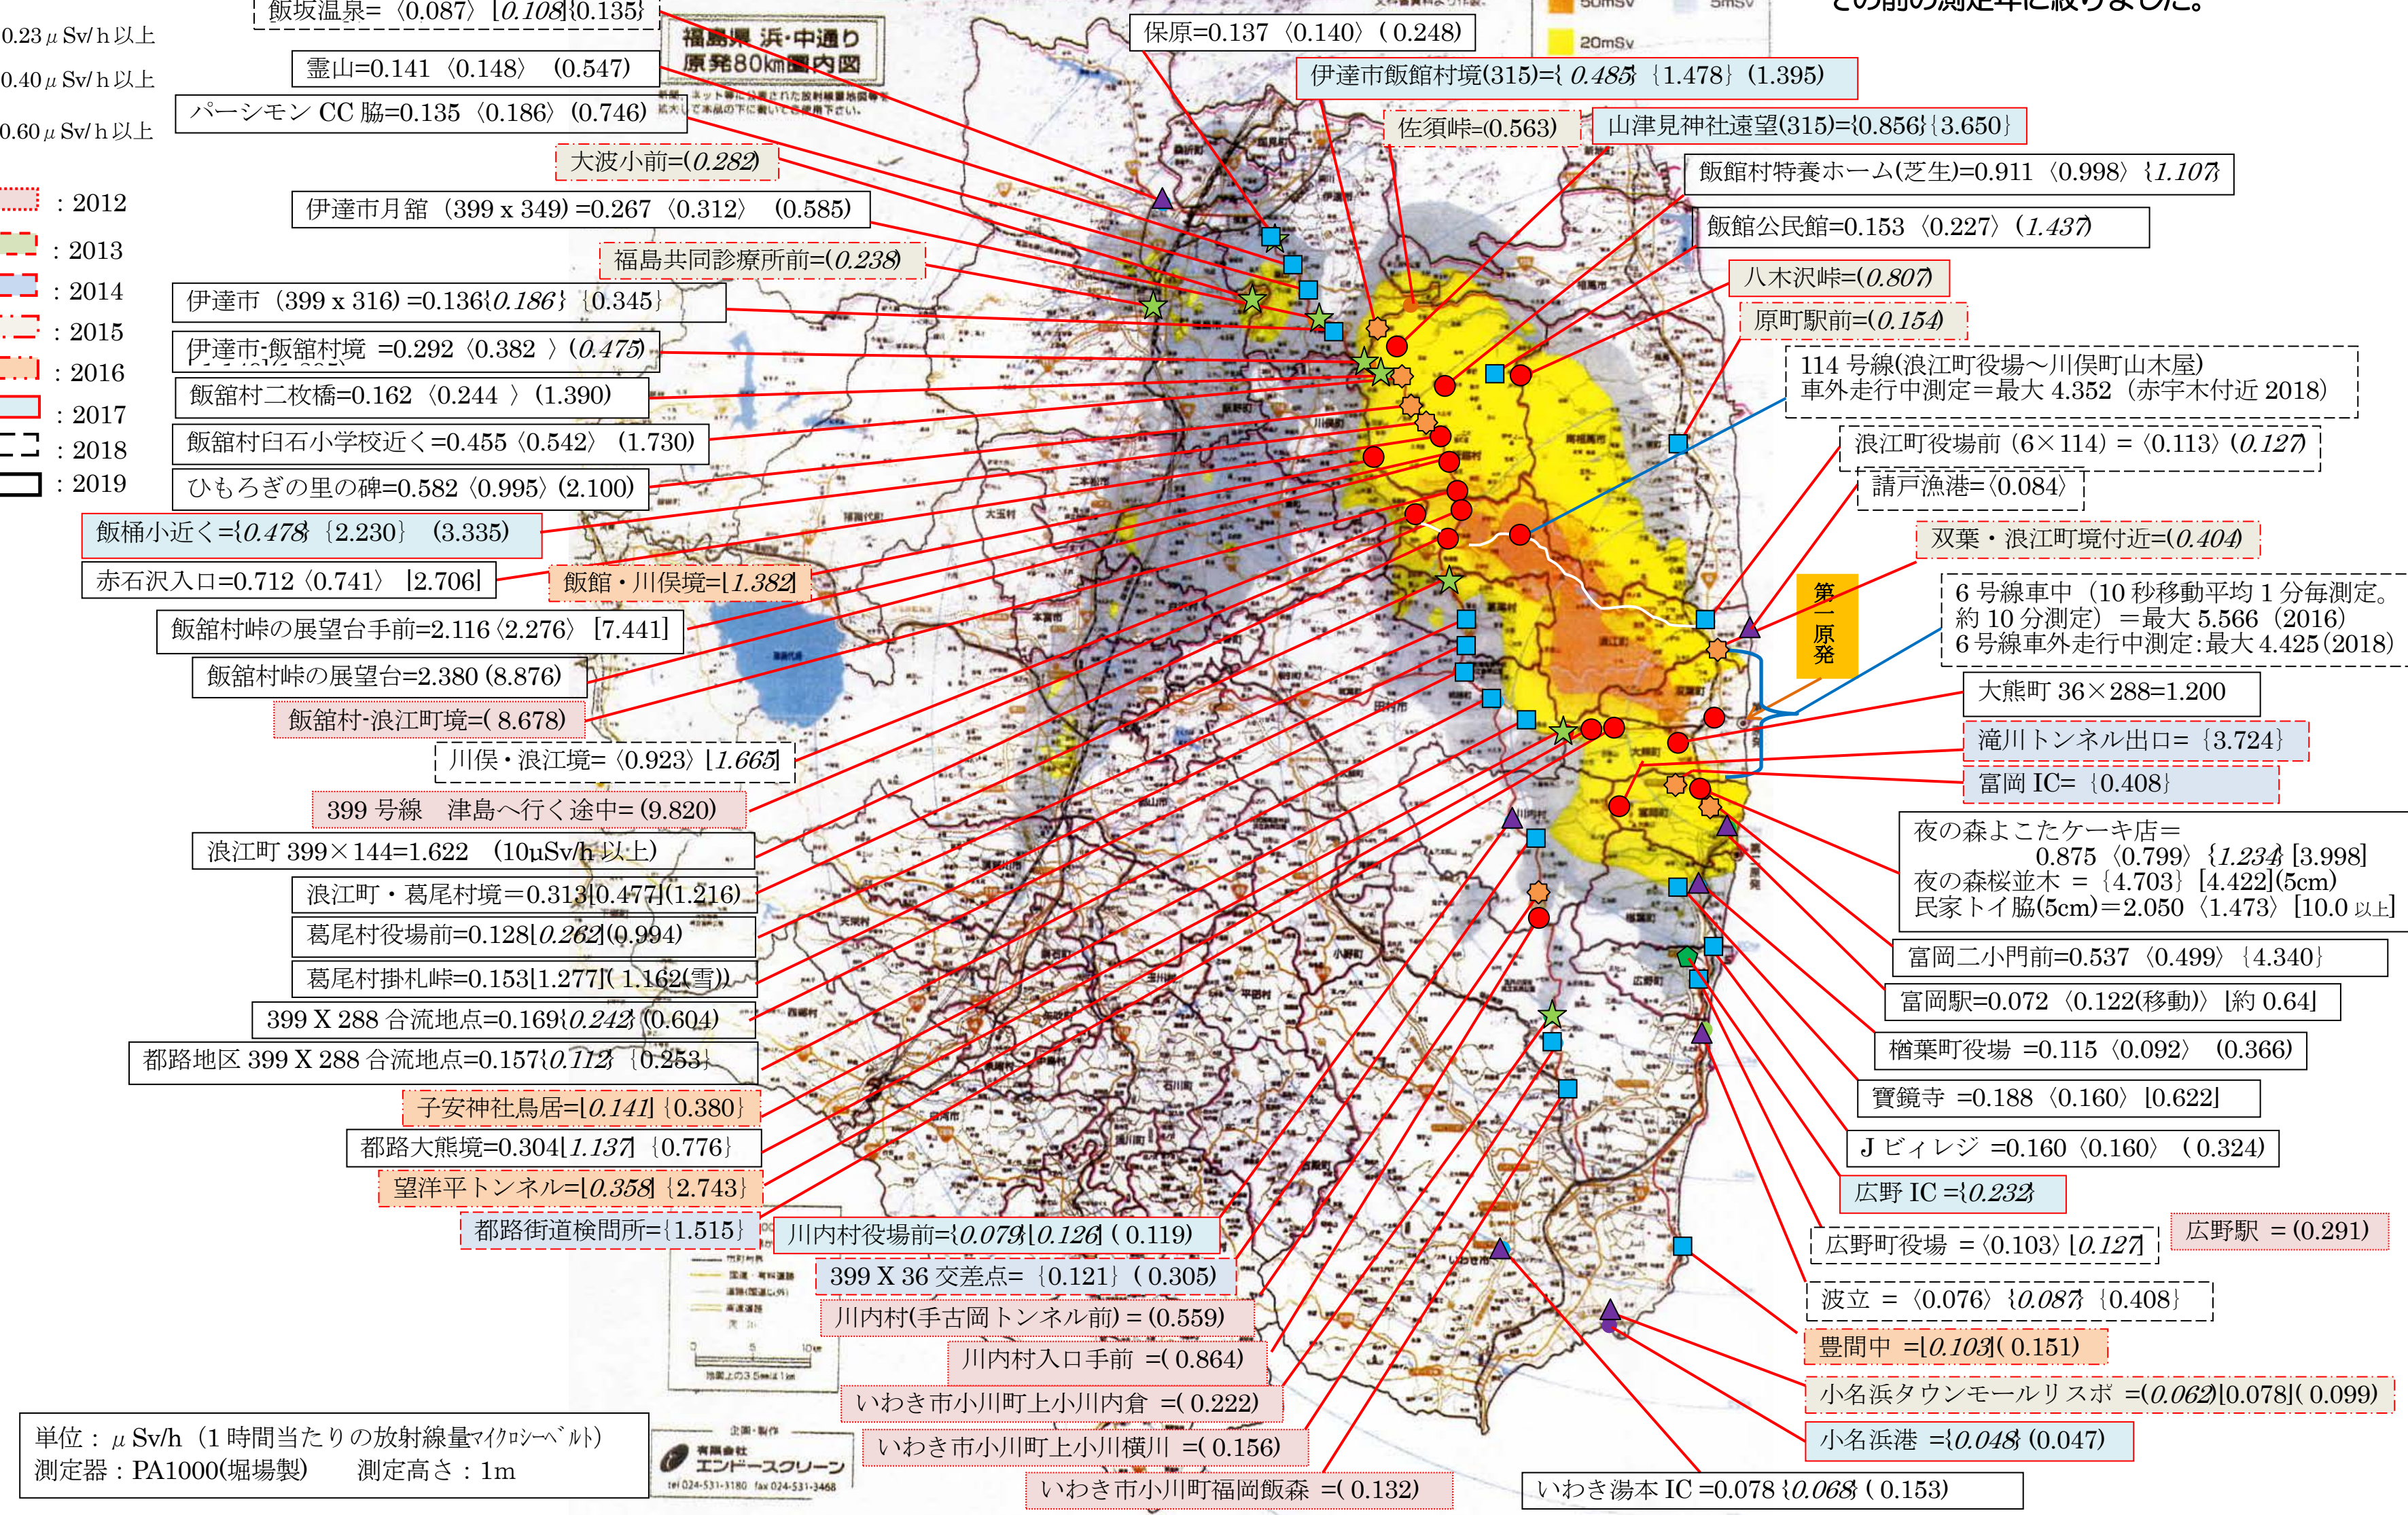

単位： μ Sv/h (1時間当たりの放射線量マイクロシーベルト)
測定器：PA1000(堀場製) 測定高さ：1m

企画・制作
有限会社
エンドースクリーン
tel 024-531-3180 fax 024-531-3468